

**ДОГОВОР**  
№ 2-1081.06-111 2014 г.  
**ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА**  
**«Апаратура за Катедра по «Неврология»»**  
*посочва се наименованието на обособената позиция/*

Днес, 06.11.2014 г., в гр. София, между:

**МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ**, с адрес: гр.София 1431, бул.”Акад. Иван Евст. Гешев” № 15, БУЛСТАТ: 831385737 и ДДС идентиф. № BG 831385737, представляван от чл. кор. проф. д-р **ВАНЬО МИТЕВ**, дм, дбн – Ректор, наричан по-долу за краткост **«ВЪЗЛОЖИТЕЛ»** от една страна,

и

Консорциум **“АДИГЛАС”**, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Тотлебен” № 34 БУЛСТАТ/ЕИК 176 720 927, идент. № по ДДС BG 176 720 927, представлявано от **Петьо Ангелов Петков** - управител, наричано за краткост по-долу **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № РК 36-1957/02.10. 2014 г. на Ректора на Медицински Университет-София се сключи настоящият договор за следното:

**I. Предмет и срок на договора**


1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да достави, монтира, въведе в експлоатация, обучи персонала за работа и осигури гаранционна поддръжка на медицинска апаратура по обособена позиция № 6 „Апаратура за Катедра по «Неврология», наричана за краткост „стока”, съгласно Таблица за техническо съответствие на предлаганата апаратура /Приложение № 16.1÷16.30/, неразделна част от настоящия договор;

1.2. Срокът на договора е до изпълнение на възложените по него дейности свързани с доставката, монтажа, пускането в експлоатация, обучението на персонала за работа с апаратурата и заплащането на стоката;

1.3. Стоката е с гаранционен срок, посочен в офертата на Изпълнителя и е 18 месеца. В рамките на този гаранционен срок и при спазени гаранционни условия Изпълнителят се задължава да извършва всички ремонти и подмяна на повредени елементи за своя сметка, а при установяване на неотстранима повреда да достави нова апаратура със същите или по-добри характеристики за негова сметка.

**II. Цена и начин на плащане**

2.1. Цената на стоката е в размер 658 300,00 лв. /шестстотин петдесет и осем хиляди и триста лева/ без ДДС или 789 960,00 лв. /седемстотин и осемдесет и девет хиляди и деветстотин и шестдесет лева/ с вкл. ДДС посочена в ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор. Цената е фиксирана в договора и не подлежи на промяна за срока на действието му.



2.2. Посочената цена включва всички разходи за доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за срок от 18 месеца.

2.3. Плащането се извършва в български лева от звеното краен получател – Медицински факултет при Медицински университет – София, по банков път, съгласно офертната цена в лева по сметката на Изпълнителя **не по-късно от 20 календарни дни** след представяне в счетоводството на Медицински факултет-Деканат на следните документи:

- Доставка фактура (оригинал) и 2 бр. заверени копия издадени с името и данните на МУ-Медицински факултет-Деканат, гр.София, бул."Св. Георги Софийски" № 1, БУЛСТАТ: 8313857370037, Иден. № BG 831385737, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;

- Приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ доставката на апаратурата, протокол за извършения монтаж и пускане в експлоатация, подписани от Изпълнителя и Ръководителя на Катедра или Клиничен център;

- Протокол за извършено обучение на персонала, който ще работи с апаратурата заедно със списъка на лицата, които подлежат на обучение, подписан от Ръководителя на Катедра или Клиничния център.

### III. Срок и място на доставката

3.1 Доставката на апаратурата следва да бъде извършена в срок от 90 календарни дни /съгласно Техническото предложение на изпълнителя - Приложение № 9/, считано от датата на подписване на договора.

3.2 Изпълнителят се задължава да уведоми писмено или чрез факс: 02/8518743 Възложителя/респективно звеното, краен получател - Медицински факултет (Катедра/Клиничен център) за предстоящата доставка не по-късно от 48 /четиридесет и осем/ часа преди извършване на доставката.

3.3 Мястото на изпълнение на доставката - Катедра/Клиничен център към Медицински факултет при Медицински университет – София, за нуждите на които се закупува настоящата апаратура.

3.4 Доставката на апаратурата се счита за извършена след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка между Ръководителя на Катедра/Клиничен център и Изпълнителя, удостоверяващи съответствието на апаратурата с техническата спецификация на Възложителя.

### IV. Права и задължения на страните


#### 4.1 Изпълнителят се задължава:

4.1.1 да достави „стоката”, предмет на настоящия договор, в уговорения срок и по договорения ред, с качество, което да отговаря на всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за провеждане на процедурата, като същата е придружена с гаранционна карта и ръководство за употреба на български език;

4.1.2 в срок до 5 работни дни след доставката да извърши монтажа и да въведе в експлоатация апаратурата, предмет на настоящия договор и да обучи персонала за работа с нея, съгласно приложен списък на лицата за работа с апаратурата подписан от Ръководителя на Катедрата/Клиничния център;

4.1.3 да представи към момента на подписване на договора **гаранция за изпълнение на договора**, в размер на 3 % от стойността му в лв. без ДДС по една от формите предвидени в чл. 60 от ЗОП - парична сума, платима по банкова сметка на Ректората на МУ - София за внасяне на паричната гаранция - IBAN: BG 78 BPBI 79403363987201 и BIC: BPBVBGSG в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена в полза на Възложителя със срок на действие 10 работни дни след приключване на договора;

4.1.4. да поддържа гаранционно стоката в срок от 18 месеца /съгласно Техническото предложение на Изпълнителя/, като гаранционния срок започва да тече от датата на



подписване на приемателно-предавателния протокол за доставка, протокол за монтаж и пускане в експлоатация, който удостоверява годността на стоката след въвеждането ѝ в експлоатация и съответствието ѝ с техническите изисквания на Възложителя;

4.1.5 гаранционното поддържане се извършва от сервиз на Изпълнителя сертифициран от производителя в рамките на гаранционния срок. Изпълнителят е длъжен да предприеме действия след направеното уведомяване от Възложителя по факс в срок до 24 /двадесет и четири/ часа. Срокът на отстраняване на повредата е не повече от 120 часа. При отстраняване на дефекти с резервни части подлежащи на доставка от внос, срокът за отстраняване на повредата се удължава с времето на доставка. В случай, че се установят скрити недостатъци, в рамките на гаранционния срок, ако недостатъкът прави стоката негодна за използване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да замени стоката с нова със същите или по-добри характеристики. Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

4.1.6 да осигури възможност за следгаранционен сервиз от сервиз на Изпълнителя сертифициран от производителя.

4.1.7 да предаде оригинална гаранционна карта и ръководство за употреба на български език на отговорно лице от Катедрата или Клиничния център.

#### **4.2. Възложителят се задължава:**

4.2.1 да заплати доставената апаратура по ред и начин посочен в настоящия договор, при условие, че същата съответства на посочените в документацията технически характеристики и след представяне на посочените в т.2.3 документи;

4.2.2 да върне след изтичането на 10 работни дни от изпълнение на настоящия договор, внесената гаранция за изпълнение, при условие, че не се наложи каширание /конфискуване/ на част от нея за някакъв вид неизпълнение. За периода, през който гаранцията законно е била в разпореждане на Възложителя не се дължат лихви;

4.2.3 определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки момент изпълнението на договора по отношение на качество, количество, стадий на изпълнение без да затрудняват дейността на Изпълнителя.

### **V. Отговорност при забава и неустойки**

5.1. При забава на изпълнението на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да внесе дължимата неустойка в срок от 3 работни дни от получаване на писмо /покана/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на МУ-София-Ректорат: IBAN- BG 43 BNBG 9661 3100 1021 01, код BNBGBGSD – БНБ – София или в касата на Ректората на Медицински университет-София, след което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършената доставка. Гаранцията за изпълнение се освобождава до 10 работни дни след извършване на доставката и внасяне на начислените неустойки по договора.


### **VI. Прекратяване:**

6. Настоящият договор се прекратява:

6.1 едностранно от Възложителя, без предизвестие и при задържане на гаранцията за изпълнение при неспазване на задълженията на Изпълнителя по чл.3.1, чл.4.1.1 и чл.4.1.2 от настоящия договор;

6.2 по взаимно съгласие на страните изразено писмено с обосновани мотиви;

6.3 Възложителя има право да прекрати договора едностранно без предизвестие при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продължила повече от половината от оферирания срок на доставка.



## VII. Форсмажорни обстоятелства

7. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако са причинени в резултат на непреодолима сила.

8. Страната, която е била в забава при изпълнение на задълженията си не може да се позовава на непреодолима сила.

9. „Непреодолима сила“ по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

Не представлява „непреодолима сила“ събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие или бездействие на някоя от страните, техни представители и/или служители.

10. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства.

11. Страната засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да сведе до минимум нанесените вреди и загуби, както и да уведоми другата страна писмено в едноседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила.

12. Срокове за изпълнение на задължения по този договор и свързаните с тях насрещни задължения спират да текат докато трае непреодолимата сила

## VIII. Спорове

13. Възникнали спорове между страни се решават чрез преговори между тях, а при неспостигане на договореност – от компетентния съд.

## IX. Съобщения

14. Всички съобщения между страните свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощени лица.

## X. Други разпоредби

15. С оглед на обстоятелството, че този договор е сключен на основание ЗОП, страните се споразумяват, неизменна част от него да се счита офертата на Участника, визиран в настоящия договор като Изпълнител.

16. Страните се споразумяват за валидни адреси и банкова сметка на Изпълнителя да се считат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

РЕКТОРАТ –бул.“Акад. Иван Гешов” №15

ет.10, стая 20

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„АДИГЛАС“

гр. София, бул. „Тотлебен“ № 34,

сграда 3, п.к. 1606, пк 121


за Изпълнителя: банкова сметка в

за: 72, аа. 1 от ДОНК

IBAN: за. 72, аа. 1 от ДОНК

BIC: F за. 72, аа. 1 от ДОНК

При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено в тридневен срок от промяната, а при промяна на посочената банкова сметка в договора, съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено веднага, в деня на промяната.



17. Никоя от страните няма право да прехвърля правата и задълженията по този договор на трети лица.

## XI. Заключителни разпоредби

18. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие до изпълнение на договорните задължения на двете страни.

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра един за Възложителя, един за звеното краен получател Медицински факултет-Деканат и един за Изпълнителя.

*Неразделна част от договора са:*

1. Техническо предложение на изпълнителя /Приложение № 9/;
2. Ценова оферта на изпълнителя /Приложение № 11/;
3. Таблица за техническо съответствие на предлаганата апаратура /Приложение № 16.1÷16.30/

*При подписване на договора се представиха следните документи:*

1. Изискваните се документи по чл. 48, ал. 2 от ЗОП;
2. Оригинал на неотменима банкова гаранция за изпълнение на името на Медицински Университет-София или платежно нареждане по сметка на Медицински университет-София-Ректорат.


**ВЪЗЛОЖИТЕЛ :**  
**РЕКТОР НА**  
**МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ**

.....  
/чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев/



**ИЗПЪЛНИТЕЛ :**  
**УПРАВИТЕЛ :**

.....  
/инж. Петьо Петков/



**СЪГЛАСУВАЩИ:**

**ДЕКАН НА**  
**МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ**  
/проф. д-р Мария Маринов, дм, дмн/



Главен счетоводител:  
/Светлана Неделчева/

Юрист:  
/адв. Албена Фурнаджиева/

Наименование на Участника:	Консорциум «Адиглас»
Седалище по регистрация:	България, София 1606, Бул. „Ген. Тотлебен” 34
БУЛСТАТ/ЕИК:	176 720 927
Точен адрес за кореспонденция:	България, София 1606, Бул. „Ген. Тотлебен” 34 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	+359 2 952 28 59
Факс номер:	+359 2 952 28 59
Лице за контакт:	Петьо Петков
e-mail за връзка:	aditus@einet.bg

ДО  
РЕКТОРА НА  
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ  
ГР.СОФИЯ 1431  
БУЛ. «АКАД. ИВАН ЕВСТ. ГЕШОВ» № 15

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
за изпълнение на обществена поръчка  
по обособена позиция № 6 „Апаратура за Катедра по „Неврология”

Наименование “ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ ВЕКСПЛОАТАЦИЯ И  
на поръчката: ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА И ДРУГА  
АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ  
МУ-СОФИЯ ПО 30 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“


**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,**

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет

Ние, от Консорциум «Адиглас» (посочете наименованието на участника) с настоящото представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция № 6 „Апаратура за Катедра по „Неврология” по обявената от Вас процедура, както следва:

№ по ред	Показател	Мярка	Предложение на участника
1	Гаранционен срок на предлаганата апаратура.	Месеци	18
2	Срок на доставка.	Календарни дни	90

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме горепосочените условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи.

**Забележка:**

1. Възложителят определя минимален и максимален гаранционен срок на предлаганата апаратура не по-малък от 12 (дванадесет) месеца и не повече от 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на оборудването. Гаранционният срок за всяко отделно оборудване, следва да е еднакъв.

2. Възложителят определя минимален и максимален срок на доставка, не по-малък от 3 (три) календарни дни и не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Към Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка прилагаме документи посочени в раздел VI. „Необходими документи“ от документацията за участие, както следва:

1. Таблица за техническо съответствие на предлаганата апаратура (по образец Приложение № 16.1+16.30) – оригинал.

2. Декларация от участника /свободен текст/ за осигуряване на гаранционно обслужване на апаратурата от сервиз на участника оторизиран от производителя при максимално време на реакция 24 часа и максимално време за отстраняване на повредата 120 часа – оригинал.

3. Декларация от участника /свободен текст/, че предлаганата апаратура отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация на Възложителя - оригинал.

4. Декларация от производителя /свободен текст/, че предлаганата апаратура е нова произведена след 01.01.2013 г. - оригинал.

5. Декларация от участника /свободен текст/ за представяне на Ръководство за експлоатация на апаратурата на български език, ако участника бъде определен за изпълнител - оригинал.

6. Декларация от производителя на апаратурата, съдържаща информация за съответствието на техническите параметри на предлаганата апаратура с параметрите от техническата спецификация – оригинал.

Съгласни сме валидността на нашето техническо предложение да бъде 180 календарни дни, но не по-малко от 180 календарни дни, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас до сключване на официален договор.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Име и фамилия, подпис: **Петьо Петков**

Длъжност: **Управител**

Наименование на участника: **Консорциум «Алтиглас»**

Печат:


Подпис и печат от участника на всяка страница!



ТАБЛИЦА  
ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА АПАРАТУРА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Апаратура за Катедра по „Неврология“


Обособена позиция №	Техническа спецификация /минимални технически изисквания към предлаганата апаратура	Бр.	количество	Съответствие да/не/полово	Предлагани от Участника технически характеристики на апаратурата	Производител/произход	Модел/година	Кат. №/ стр. от каталог
6.1.	Компютърен периметър	Бр.	1			Роденшток (Rodenstock)	Периметър Perimat 2014	Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
1,1	Периметър за кинетични и статични тестове			да	Периметър за кинетични и статични тестове			Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
1,2	Вграден компютър, с USB интерфейс, Възможност за предаване на данните чрез мрежов интерфейс; Операционна система Windows			да	Вграден компютър, с USB интерфейс, Възможност за предаване на данните чрез мрежов интерфейс; Операционна система Windows			Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
1,3	Цветно (RGB) осветление - LED използване на Голдманн V фиксиране на петното; Режим на кинетичен тест; Стимули с регулируем размер, интензитет и скорост -- движещи се от периферията към центъра на сферата			да	Цветно (RGB) осветление - LED технология: Тест Син/Жълт, с използване на Голдманн V фиксиране на петното; Режим на кинетичен тест; Стимули с регулируем размер, интензитет и скорост -- движещи се от периферията към центъра на сферата			Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
1,4	Стимули с Голдманн размер III, V			да	Стимули с Голдманн размер III, V			Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
1,5	Електронно (програмно) регулиране на опората за брадичката			да	Електронно (програмно) регулиране на опората за брадичката			Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2



*[Handwritten signature]*




1,6	Измерване на диаметъра на зеницата по всяко време – преди, след ипо време на изследването	да	Измерване на диаметъра на зеницата по всяко време – преди, след ипо време на изследването	Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
1,7	Следене на очни движения с цифрова камера ("eye-tracking"):	да	Следене на очни движения с цифрова камера ("eye-tracking"):	Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
1,8	Неприетите записи да могат да се повторят веднага	да	Неприетите записи да могат да се повторят веднага	Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
1,9	Непрекъснато изображение на окото по време на изследването – за контрол от оператора	да	Непрекъснато изображение на окото по време на изследването – за контрол от оператора	Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
1,10	Интегриран контрол за мониториране на съпътното петно по метода на Heijl-Krakau	да	Интегриран контрол за мониториране на съпътното петно по метода на Heijl-Krakau	Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
1,11	Кратко време за изследване: "Използване", от апарата, на предишни протоколи от изследване на същия пациент, с цел познатите, отпреди, проблеми да не се изследват повторно	да	Кратко време за изследване: "Използване", от апарата, на предишни протоколи от изследване на същия пациент, с цел познатите, отпреди, проблеми да не се изследват повторно	Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
1,13	Автоматична адаптация към пациентния отговор – за оптимизиране на всички времеви параметри	да	Автоматична адаптация към пациентния отговор – за оптимизиране на всички времеви параметри	Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
2	<b>Технически и работни параметри:</b>			
2,1	Кинетичен тест	да	Кинетичен тест	Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
2,2	Тестови полета: 30°, 40°, 50°	да	Тестови полета: 30°, 40°, 50°	Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
2,3	Меридианни ъгли: 0° до 360° със стъпки 10°, 15°, 20°, 30° или 45°	да	Меридианни ъгли: 0° до 360° със стъпки 10°, 15°, 20°, 30° или 45°	Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
2,4	Изоттери: минимум 8	да	Изоттери: 8	Роденшток ПЕРИМАТ



*[Handwritten signature]*

							Стр. 2
2,5	Скорост на стимулите: 2°/сек, 4°/сек, 6°/сек, 8°/сек	да	Скорост на стимулите: 2°/сек, 4°/сек, 6°/сек, 8°/сек				Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
3	Параметри на измервателната сфера:						
3,1	Затворена "кула" с вентилация	да	Затворена "кула" с вентилация				Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
3,2	Радиус: 30 см	да	Радиус: 30 см				Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
3,3	Измервателен обхват: ±50°	да	Измервателен обхват: ±50°				Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
4	Светлинни източници:						
4,1	Централен, жълт, LED технология (588 нанометра), 2 фиксиращи източника разположени на ±30° за тест за движение (driver test), измервателен обхват 160°, 2 фиксиращи "диаманти" (нецентрално зрение, сензитивност на фовеата)	да	Централен, жълт, LED технология (588 нанометра), 2 фиксиращи източника разположени на ±30° за тест за движение (driver test), измервателен обхват 160°, 2 фиксиращи "диаманти" (нецентрално зрение, сензитивност на фовеата)				Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
4,2	Осветяване: LED осветление, Максимален интензитет 10 000Asb	да	Осветяване: LED осветление, Максимален интензитет 10 000Asb				Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
4,3	Вградена система за контрол на интензитета	да	Вградена система за контрол на интензитета				Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
4,4	Тестови полета: Зелено / Бяло, Синьо / Червено	да	Тестови полета: Зелено / Бяло, Синьо / Червено				Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
4,5	Пълно поле: мин. 50°	да	Пълно поле: 50°				Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
4,6	Глаукома: мин. 22°/50°	да	Глаукома: 22°/50°				Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2



Handwritten signature at the bottom right of the page.

4,7	Централно: мин. 22°/30°	Да	Централно: 22°/30°		Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
4,8	Широко: мин. 22°/30°	Да	Широко: 22°/30°		Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
4,9	Периферно: мин. 30°-50°	Да	Периферно: 30°-50°		Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
4,10	Макула: мин. 10°	Да	Макула: 10°		Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
4,11	Движещо: мин. 50°/80°	Да	Движещо: 50°/80°		Роденшток ПЕРИМАТ Стр. 2
6.2.	Оптично-кохерентен томограф			Бр. 2	Каталог RS-3000_Adv ance_LiteE.p df
1,1	Не-мидриатичен инфрачервен конфокален сканиращ лазерен офтальмоскоп	Да	Не-мидриатичен инфрачервен конфокален сканиращ лазерен офтальмоскоп		Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df
1,2	Детайлизиран образ на фундуса	Да	Изображение от сканиращ лазерен офтальмоскоп		Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df
1,3	Вграден DLP (Digital Light Processing -- Цифрова Светлинна Обработка) прожектор за фиксиране на избрания обект	Да	Вграден DLP (Digital Light Processing -- Цифрова Светлинна Обработка) прожектор за фиксиране на избрания обект		Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df
2	Технически параметри на лазерния офтальмоскоп:				
2,1	Голямина на полето: 30°x30° квадрат	По- добр о	40° x 30°		Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df
2,2	Инфрачервен лазер – дължина на вълната: 920 nm (нанометра)	Да	Инфрачервен лазер		Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


2,3	Брой пиксели: мин. 512x512	Да	Брой пиксели: мин. 512x512				Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df
2,4	Честота на опресняване: 16 кадъра за секунда	Да	Честота на опресняване: 16 кадъра за секунда				Техническа спецификация RS-3000 Advance стр. 129
2,5	Цифрова дълбочина на образа: 23 µm (микрометра)	Да	Цифрова дълбочина на образа: 25 µm				
2,6	Регулиране на фокуса, фиксиране - вътрешно, външно	Да	Регулиране на фокуса, фиксиране - вътрешно, външно				
2,7	Усредняване на образите с вграден "eye-tracker"; Възможност за усановяване на позицията на последното изследвано място	Да	Усредняване на образите с вграден "eye-tracker"; Възможност за усановяване на позицията на последното изследвано място				Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df
2,8	Фиксиране на всяко петно от ретината за изследване на периферното зрение	Да	Фиксиране на всяко петно от ретината за изследване на периферното зрение				Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df
2,9	Окомплектван с мощна съвременна компютърна система, цветен монитор, цветен принтер. Работна среда MS Windows	Да	Окомплектван с мощна съвременна компютърна система, цветен монитор, цветен принтер. Работна среда MS Windows				Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df
3	Модул ОСТ – оптична кохерентна томография – позволяващ екзактен анализ на морфологията:						
3,1	Възможност за избор на сканиране: хоризонтално/вертикално, Линейно сканиране, Кръгово сканиране, Обемно сканиране	Да	Възможност за избор на сканиране: хоризонтално/вертикално, Линейно сканиране, Кръгово сканиране, Обемно сканиране Scan pattern (retina)				Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df
3,2	Оптимизиран хардуер за получаване на високо качество с единичен скан	Да	Оптимизиран хардуер за получаване на високо качество с единичен скан				Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df
3,3	Вграден ОСТ "tracker"	Да	Вграден ОСТ "tracker"				Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p df




Handwritten signature at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

3,4	Детектиране на до 7 слоя автоматично и визуализирането им чрез карти за дебелината	Да	Детектиране на до 7 слоя автоматично и визуализирането им чрез карти за дебелината	Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p cf
3,5	Скорост на сканиране: 25 000 А-скена за секунда	По-добро	53 000 А-скена за секунда	Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p cf
3,6	ОСТ суперлуминисцентен диод	Да	880 nm	Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p cf
3,7	Дълбочина на сканиране: 2 – 2.5mm	Да	2,1 mm	Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p cf
3,8	Аксиална резолюция: 5 μm (микрометра)	Да	Аксиална резолюция: 4 μm (микрометра)	Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p cf
3,9	Трансверзална резолюция: 15 μm (микрометра)	Да	Трансверзална резолюция: 15 μm (микрометра)	Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p cf
3,10	Възможност за интегриране на модул Ангиография	Да	Възможност за интегриране на модул Ангиография	Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p cf
3,11	Лазерен източник – син: 488nm, за генериране на висококачествени фундус – образци, цветен образ 512x512, запис 15 образа за секунда	Да	Лазерен източник – син: 488nm, за генериране на висококачествени образци, цветен образ 512x512, запис 15 образа за секунда	Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p cf
3,12	Автоматично включване на Ангиографски режим и видео-запис със старта на инжектиране	Да	Автоматично включване на Ангиографски режим и видео-запис със старта на инжектиране	Каталог RS_3000_Adv ance_LiteE.p cf
6.3.	Шпалт-лампа (биомикроскоп)	Бр. 2	Роденшто к (Rodensto ck)	Rodenstock Silt Lamps RSL 3000 Стр. 4




1,1	Микроскоп с конвергентен бинюкулярен тубус	Да	Микроскоп с конвергентен бинюкулярен тубус	Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 4
1,2	Конвергентен ъгъл: 10°	Да	Конвергентен ъгъл: 10°	Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 4
1,3	Петстепенно увеличение: 6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x (Галилеанска система)	Да	Петстепенно увеличение: 6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x (Галилеанска система)	Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 4
1,4	Размер на полето: 32 мм, 20 мм, 13 мм, 8 мм, 5 мм	Да	Размер на полето: 32 мм, 20 мм, 13 мм, 8 мм, 5 мм	Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 4
1,5	Окуларно увеличение: поне 12.0	Да	Окуларно увеличение: 12.5 x	Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 4
1,6	Междузенично разстояние: поне 52 - 77 мм	Да	Междузенично разстояние: 52 - 77 мм	Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 4
1,7	Компенсация на рефрактивната грешка: -8.0 до +8.0 dpt	Да	Компенсация на рефрактивната грешка: -8.0 до +8.0 dpt	Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 4
1,8	Размери на образа: ширина 0 - 8 мм, дължина 1 - 8 мм (непрекъсната); Радикален обхват: хоризонтален ±90°, вертикален ±30°	Да	Размери на образа: ширина 0 - 8 мм, дължина 1 - 8 мм (непрекъсната); Радикален обхват: хоризонтален ±90°, вертикален ±30°	Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 4
1,9	Филтри: Син, Свободен червен (зелен), сив (10%), топлинна абсорбция	Да	Филтри: Син, Свободен червен (зелен), сив (10%), топлинна абсорбция	Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 4
1,10	Осветяване: LED осветяване	Да	Осветяване: LED осветяване	Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 4
2	Видео система:	Да	Осветяване: LED осветяване Rodacam	Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 4



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

2,1	Запис на видео и образи	Да	Запис на видеос и образи			Стр. 3
2,2	LED фоново осветление	Да	LED фоново осветление			Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 3
2,3	Контролен пулт върху микроскопа	Да	Контролен пулт върху микроскопа			Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 3
2,4	Вграден 3.5 инча LCD цветен дисплей	Да	Вграден 3.5 инча LCD цветен дисплей			Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 3
2,5	Цифрово увеличение	Да	Цифрово увеличение			Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 3
2,6	Програмно осигуряване за цифрова документация	Да	Програмно осигуряване за цифрова документация			Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 3
2,7	Интегриран слот за SD карти	Да	Интегриран слот за SD карти			Rodenstock Slit Lamps RSL 3000 Стр. 3
6.4.	Видеокапилароскоп от най-висок клас	Бр. 1	Optilia Video Instrument AB Швеция	Optilia Video Capillaroscope Medisco pe 2014		
1,1	Цифров микроскоп за видео капилароскопия със специализирано програмно осигуряване	Да	Цифров микроскоп за видео капилароскопия със специализирано програмно осигуряване			Optilia Video Capillaroscope Medisco pe Стр. 2


*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


1,2	Възможност за работа с лещи с висока разделителна способност с увеличение 200x и 100x	Да	Възможност за работа с лещи с висока разделителна способност с увеличение 200x и 100x	Optilia Video Capillaroscop Стр. 4
1,3	Вградено осветление	Да	Вградено осветление	Optilia Video Capillaroscop Стр. 4
1,4	Възможност за безконтактно изследване	Да	Възможност за безконтактно изследване	Optilia Video Capillaroscop Стр. 4
1,5	Лек, удобен за пренасяне	Да	Лек, удобен за пренасяне	Optilia Video Capillaroscop Стр. 4
1,6	Специализиран софтуер за изобразяване и анализ, измерване и база данни на пациентите	Да	Специализиран софтуер за изобразяване, анализ, измерване и база данни на пациентите	Optilia Video Capillaroscop Стр. 3
1,7	Възможност за експорт на данните в други системи	Да	Възможност за експорт на данните в други системи	Optilia Video Capillaroscop Стр. 3
1,8	Научна изобразителна платформа за картографиране на изследваните обекти	Да	Научна изобразителна платформа за картографиране на изследваните обекти	Optilia Video Capillaroscop Стр. 3
1,9	Морфологични изследвания		Морфологични изследвания	Optilia Video Capillaroscop Стр. 3
6.5.	Апаратура и програми за съвременно видео-ЕЕГ мониторингране и полисомнография	Бр. 1		Micromed Италия Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM SD LTM 64 Express 2014



Handwritten signature and the number '37' at the bottom of the page.




1.1	64 работни канала. от които - поне 5 с възможност за полиграфски запис (биополярни)	Да	64 работни канала. от които - поне 5 с възможност за полиграфски запис (биополярни)	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 2
1.2	DC канали, канали за оксиметрия, канал за позиция на тялото, канали за регистриране на респираторни усилия; Необходими електроди и сензори за всички изследвания	Да	DC канали, канали за оксиметрия, канал за позиция на тялото, канали за регистриране на респираторни усилия; Необходими електроди и сензори за всички изследвания	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 2
1.3	Възможност за непрекъснат запис на всички канали едновременно	Да	Възможност за непрекъснат запис на всички канали едновременно	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 2
1.4	Възможност за автономна работа на усилвателите (като амбулаторен холтер-рекордер), отделно от системата за мониториране; запис на данните върху вградена в усилвателя памет	Да	Възможност за автономна работа на усилвателите (като амбулаторен холтер-рекордер), отделно от системата за мониториране; запис на данните върху вградена в усилвателя памет	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 3
1.5	Резервен запис върху вградена памет ("Back-up memory") и възстановяване на данните след преустановяване на връзката	Да	Резервен запис върху вградена памет ("Back-up memory") и възстановяване на данните след преустановяване на връзката	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 3
1.6	Възможност за интегриране на 64 канален кортикален стимулатор	Да	Възможност за интегриране на 64 канален кортикален стимулатор	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 8



Handwritten signature at the bottom right of the page.

1,7	Синхронизирана видео система (видео ЕЕГ) с Full HD видео 1920x1080 (камери, наблюдение, запис, анализ)	Да	Синхронизирана видео система (видео ЕЕГ) с Full HD видео 1920x1080 (камери, наблюдение, запис, анализ)	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 5,6
2	Технически параметри (пациентна кутия, усилватели):			
2,1	Брой на каналите: 64	Да	Брой на каналите: 64	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 2
2,2	Разширена защита от радиочестоти	Да	Разширена защита от радиочестоти	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 2
2,3	Честота на дискретизация: 2048Hz	Да	Честота на дискретизация: 2048Hz	SD LTM 64 Express Systeem PLUS Evolution Стр. 2
2,4	Нискошумови диференциални входове за всички канали	Да	Нискошумови диференциални входове за всички канали	SD LTM 64 Express Systeem PLUS Evolution Стр. 2
2,5	Шум: < 0.5µV rms	Да	Шум: < 0.5µV rms	SD LTM 64 Express Systeem PLUS Evolution Стр. 2




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2.6			Да	Входен импеданс: > 10 <sup>12</sup> Ω	SD LTM 64 Express System PLUS Evolution Стр. 2
2.7	Входен импеданс: > 1012 Ω Технически параметри на електрически кортикален стимулатор				
2.8	Възможност за избор на положителен и отрицателен електрод за всеки от 64 изхода	Да	Възможност за избор на положителен и отрицателен електрод за всеки от 64 изхода	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 8	
2.9	Тип и интензитет на стимулите: Постоянен ток, бифазни и монофазни стимули 1.0 до 15.0mA	Да	Тип и интензитет на стимулите: Постоянен ток, бифазни и монофазни стимули 0.0 до 15.0mA	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 8	
2.10	Дължина на импулсите: 30.0 микроволта до 1 миливолт;	Да	Дължина на импулсите: 0.025 милисекунди до 1 милисекунда	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 8	
2.11	Честота на стимулиране: 0.1 до 300 Hz	Да	Честота на стимулиране: 0.06 до 300 Hz	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 8	
2.12	Вграден изходен тригер. Кабелно и безжично управление на стимулатора от работната станция; Наличие на кабелно управление. Задължително Безжично управление	Да	Вграден изходен тригер. Кабелно и безжично управление на стимулатора от работната станция; Наличие на кабелно управление. Задължително Безжично управление	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 8	



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

3	Специализирани изследвания, конфигурация, работни режими:			Да					Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 2,3
3,1	Регистрираща 64 канална система с вградена памет			Да			Регистрираща 64 канална система с вградена памет		SD LTM 64 Express Sysytem PLUS Evolution Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 2,3
3,2	Специализиран софтуер за многоканална работа: запис и преглед, анализ			Да			Специализиран софтуер за многоканална работа: запис и преглед, анализ		Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 5
3,3	Full HD видео (1920x1080)			Да			Full HD видео (1920x1080)		Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_SerV Стр. 1
3,4	Компютър, подвижна количка за системата			Да			Компютър, подвижна количка за системата		
3,5	Електроди, сензори, аксесоари за работа на системата			Да			Електроди, сензори, аксесоари за работа на системата		

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten signature]*

3.6	Специализиран софтуер за ERP "Event Related Potentials"	Да	Специализиран софтуер за ERP "Event Related Potentials"	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_Serv Стр. 7
3.7	Специализиран софтуер за "high-definition" (HD) синхронизирано цифрово видео EEG до 64 канала	Да	Специализиран софтуер за "high-definition" (HD) синхронизирано цифрово видео EEG до 64 канала	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_Serv Стр. 4,5
3.8	Камера с PTZ контрол (панорама, наклон, увеличение), автоматична комутираща лампа, вградена аудио-система, микрофон	Да	Камера с PTZ контрол (панорама, наклон, увеличение), автоматична комутираща лампа, инфрачервена лампа, вградена аудио-система, микрофон	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_Serv Стр. 4,5,6
3.9	Автоматично превключване кабелно-безкабелно предаване на данните (между записващата станция и усилвателите)	Да	Автоматично превключване кабелно-безкабелно предаване на данните (между записващата станция и усилвателите)	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_Serv Стр. 3
3.10	Вграден графичен дисплей и вградена клавиатура в пациентната кутия, за лесно директно управление на работните параметри	Да	Вграден графичен дисплей и вградена клавиатура в пациентната кутия, за лесно директно управление на работните параметри	Brain Quick 3200 ACQ DV/LTM Техническо описание D8513.1_Serv Стр. 2
3.11	Възможност за надграждане до 256 канала	Да	Възможност за надграждане до 256 канала	SD LTM 64 Express Sysytem PLUS Evolution Стр. 4
6.6.	Апаратура за транскраниална магнитна стимулация	Бр. 1	MagVeriturg e	MagPro R30


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

						Топика Дания	
1.1	Работна честота – 30 пулса за секунда с възможност за надграждане до 60 пулса за секунда	Да	Работна честота – 30 пулса за секунда с възможност за надграждане до 60 пулса за секунда			Брошура MagPro by MagVenture Стр. 4	
1.2	Изходна мощност: при 5пс – до 100%, при 10пс – до 100%, при 20пс – до 80%, при 30пс – до 65%	Да	Изходна мощност: при 5пс – до 100%, при 10пс – до 100%, при 20пс – до 80%, при 30пс – до 65%			Брошура MagPro by MagVenture Стр. 3, 4	
2	Режими на работа (импулси):	Да					
2.1	Бифазни („пълна“ синусоида)	Да	Бифазни („пълна“ синусоида)			Брошура MagPro by MagVenture Стр. 2, 4	
2.2	Възможност за надграждане за: Двойка стимули с честота до 5 пулсови двойки за секунда – бифазни, Монофазни стимули	Да	Възможност за надграждане за: Двойка стимули с честота до 5 пулсови двойки за секунда – бифазни, Монофазни стимули			Брошура MagPro by MagVenture Стр. 4	
2.3	Вградено компютърно управление и задаване на параметрите на терапевтичния процес	Да	Вградено компютърно управление и задаване на параметрите на терапевтичния процес			Брошура MagPro by MagVenture Стр. 2	
3	Информация за работните данни и протокол:	Да					
3.1	По време на работа: показване на реализираната стимулация (di/dt), показване на оставащите възможни пулсове	Да	По време на работа: показване на реализираната стимулация (di/dt), показване на оставащите възможни пулсове			Брошура MagPro by MagVenture Стр. 3	
3.2	След стимулация: Експорт на стимулационните параметри (в електронен вид), трансфер на данните на магнитен носител	Да	След стимулация: Експорт на стимулационните параметри (в електронен вид), трансфер на данните на магнитен носител			Брошура MagPro by MagVenture Стр. 3	
3.3	Вградена програма за определяне на моторния праг (EMГ). Електроди за EMГ	Да	Вградена програма за определяне на моторния праг (EMГ). Електроди за EMГ			Брошура MagPro by MagVenture Стр. 2	
3.4	Вграден тригер за входни тригериращи импулси:	Да	Вграден тригер за входни тригериращи импулси:			Брошура MagPro by MagVenture Стр. 2	




*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

3,5	Разпознаване на TTL и CMOS нива	Да	Разпознаване на TTL и CMOS нива	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 2,3
3,6	Входен импеданс: >10 K $\Omega$	Да	Входен импеданс: >10 K $\Omega$	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 2,3
3,7	Възможност за дефиниране на полярността от потребителя	Да	Възможност за дефиниране на полярността от потребителя	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 2,3
3,8	Вграден тригер за изходни тригерирани импулси:	Да	Вграден тригер за изходни тригерирани импулси:	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 2,3
3,9	Изходен импеданс: <200 $\Omega$	Да	Изходен импеданс: <200 $\Omega$	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 2,3
3,10	Възможност за дефиниране на полярността от потребителя	Да	Възможност за дефиниране на полярността от потребителя	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 2,3
3,11	Системата да бъде окомплектована с кръгла бобина с диаметър 120 мм, с възможност поне за 2000 пулса непрекъсната стимулация, количка за апарата и принадлежностите, специално рамо, осигуряващо неподвижност на бобината по време на стимулация	Да	Системата е окомплектована с кръгла бобина с диаметър 120 мм, с възможност поне за 2000 пулса непрекъсната стимулация, количка за апарата и принадлежностите, специално рамо, осигуряващо неподвижност на бобината по време на стимулация	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 5
3,12	Производителят да притежава сертификат за предлаганата апаратура за: «Третиране на Основни Депресивни Заболявания», в съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, Анекс II	Да	Производителят притежава сертификат за предлаганата апаратура за: «Третиране на Основни Депресивни Заболявания», в съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, Анекс II, който е приложен в документацията	
4	Възможност за работа със следните видове бобини:			




*Handwritten signature*

4.1	Кръгла, стандартна с над 200 пулса при 100% мощност	Да	Кръгла, стандартна с над 200 пулса при 100% мощност	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 5
4.2	Фигура 8, стандартна с над 170 пулса при 100% мощност	Да	Фигура 8, стандартна с над 170 пулса при 100% мощност	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 5
4.3	Кръгла, статично охлаждане	Да	Кръгла, статично охлаждане	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 5
4.4	Фигура 8, статично охлаждане	Да	Фигура 8, статично охлаждане	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 5
4.5	Елипсовидна - за функционална магнитна стимулация, стандартна	Да	Елипсовидна - за функционална магнитна стимулация, стандартна	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 5
4.6	Кръгла, динамично охлаждане	Да	Кръгла, динамично охлаждане	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 5
4.7	Фигура 8, динамично охлаждане	Да	Фигура 8, динамично охлаждане	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 5
4.8	Бобини за работа в ЯМР (ядрено-магнитен резонанс)	Да	Бобини за работа в ЯМР (ядрено-магнитен резонанс)	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 5
4.9	Параболни бобини с вграден контрол на мощността	Да	Параболни бобини с вграден контрол на мощността	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 5
4.10	Специализирани бобини за научни изследвания (phaseo coil, комбинирани — phaseo и активна страна). Бобини за поне 20 000 пулса без прекъсване	Да	Специализирани бобини за научни изследвания (phaseo coil, комбинирани — phaseo и активна страна). Бобини за поне 20 000 пулса без прекъсване	Брошура MagPro by MagVenture Стр. 5
6.7.	Автоматичен рефрактометър	Бр. 1		Роденшток Rodenstock CX 2000 Роденшток Rodenstock 2000 Autorefractometer Keratometer

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




*[Handwritten signature]*



1,1	Авторефрактор-кератометър, управляем с ръкохватка и сензитивен цветен екран "touch-screen"	Да	Авторефрактор-кератометър, управляем с ръкохватка и сензитивен цветен екран "touch-screen"	ск)	2014	Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2, 1
1,2	Автоматично подравняване на работната рамка и автоматично измерване на параметрите	Да	Автоматично подравняване на работната рамка и автоматично измерване на параметрите			Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
1,3	Вграден цветен "touch-screen" за мониториране на операциите и изобразяване на резултатите	Да	Вграден цветен "touch-screen" за мониториране на операциите и изобразяване на резултатите			Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
1,4	Измерване в режими рефракция и кератометрия за по-малко от 4 секунди	Да	Измерване в режими рефракция и кератометрия за по-малко от 4 секунди			Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
1,5	Кератометрично измерване на централни и периферни стойности. Възможност за измерване от роговицата и от обратната страна на контактни лещи	Да	Кератометрично измерване на централни и периферни стойности. Възможност за измерване от роговицата и от обратната страна на контактни лещи			Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
1,6	Ръкохватка за управление, изработена по най-нова технология	Да	Ръкохватка за управление, изработена по най-нова технология			Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
1,7	Електронно регулиране на опората за брадичката	Да	Електронно регулиране на опората за брадичката			Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
2	Измерване на рефрактивната мощност	Да	Измерване на рефрактивната мощност			Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
2,1	Сферична (SPH): -25.0 D до +22.0 D (при VD 12.0mm)	Да	Сферична (SPH): -25.0 D до +22.0 D (при VD 12.0mm)			Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
2,2	Цилиндрична: 0 D до $\pm 10.0$ D (при VD 12.0mm)	Да	Цилиндрична: 0 D до $\pm 10.0$ D (при VD 12.0mm)			Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

2,3	Изобразителни единици: 0.01 D, 0.12 D, 0.25 D	Да	Изобразителни единици: 0.01 D, 0.12 D, 0.25 D	Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
2,4	Аксиален ъгъл при астигматизъм (AXIS): 0° до 180°	Да	Аксиален ъгъл при астигматизъм (AXIS): 0° до 180°	Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
2,5	Изобразителни единици при астигматизъм: 1°	Да	Изобразителни единици при астигматизъм: 1°	Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
2,6	Минимален диаметър на зеницата: 2.2 мм	Да	Минимален диаметър на зеницата: 2.2 мм	Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
2,7	Дистанция до вертекса: 0 мм, 12.0 мм, 13.5 мм, 14.0 мм, 15.5 мм, 16.0 мм	Да	Дистанция до вертекса: 0 мм, 12.0 мм, 13.5 мм, 14.0 мм, 15.5 мм, 16.0 мм	Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
2,8	Време за измерване: 0.2 секунди/за едно око (набиране на данните);	Да	Време за измерване: 0.2 секунди/за едно око (набиране на данните);	Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
3	Роговични измервания:	Да		
3,1	Кривина (K1, K2, AVG), 5 mm до 11 mm	Да	Кривина (K1, K2, AVG), 5 mm до 11 mm	Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
3,2	Изобразителни единици: 0.01 mm		Изобразителни единици: 0.01 mm	
3,3	Рефрактивна мощност (K1, K2, AVG): 30.7 D до 67.0 D		Рефрактивна мощност (K1, K2, AVG): 30.7 D до 67.0 D	
3,4	Астигматизъм (CYL): 0 D до 0.0 D	Да	Астигматизъм (CYL): 0 D до 0.0 D	Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2
3,5	Изобразителни единици: 0.01 D	Да	Изобразителни единици: 0.01 D	Rodenstock Autorefractor-Keratometer Стр. 2



Handwritten signature at the bottom right of the page.


3,6	Аксиален ъгъл при астигматизъм (AXIS): 0° до 180°	Да	Аксиален ъгъл при астигматизъм (AXIS): 0° до 180°	Стр. 2
3,7	Изобразителни единици при астигматизъм: 1°	Да	Изобразителни единици при астигматизъм: 1°	Стр. 2
3,8	Диаметър на роговицата: 3.0 мм / 6.0 мм (при 8.0 мм роговична кривина)	Да	Диаметър на роговицата: 3.0 мм / 6.0 мм (при 8.0 мм роговична кривина)	Стр. 2
3,9	Време за измерване: 0.1 секунди/за едно око (набиране на данните)	Да	Време за измерване: 0.1 секунди/за едно око (набиране на данните)	Стр. 2
4	Измерване на зенична дистанция:	Да		Стр. 2
4,1	Измервателен интервал: 50 до 85 мм	Да	Измервателен интервал: 50 до 85 мм	Стр. 2
4,2	Изобразителни единици: 1 мм	Да	Изобразителни единици: 1 мм	Стр. 2
5	Измерване на роговичен и зеничен диаметри:	Да	Измерване на роговичен и зеничен диаметри:	Стр. 2
5,1	Измервателен интервал: 1 до 14мм	Да	Измервателен интервал: 1 до 14мм	Стр. 2
5,2	Изобразителни единици: 0.1 мм	Да	Изобразителни единици: 0.1 мм	Стр. 2

*Handwritten signature*



5,3	Наблюдателен обхват: около 15 мм x 9 мм	Да	Наблюдателен обхват: около 15 мм x 9 мм	Rodenstock Autorefractor Keratometer Стр. 2
6	Автоматично подравняване:	Да		Rodenstock Autorefractor Keratometer Стр. 2
6,1	Нагоре -- надолу, наляво -- надясно	Да	Нагоре -- надолу, наляво -- надясно	Rodenstock Autorefractor Keratometer Стр. 2
6,2	Посоки: 7 мм	Да	Посоки: 7 мм	Rodenstock Autorefractor Keratometer Стр. 2
6,3	фокусна посока: 5 мм	Да	фокусна посока: 5 мм	Rodenstock Autorefractor Keratometer Стр. 2
7	Подвижни части на апарата, обхват на движение:	Да		Rodenstock Autorefractor Keratometer Стр. 2
7,1	Напред -- назад: 40 мм	Да	Напред -- назад: 40 мм	Rodenstock Autorefractor Keratometer Стр. 2
7,2	Наляво -- надясно: 87 мм	Да	Наляво -- надясно: 87 мм	Rodenstock Autorefractor Keratometer Стр. 2
7,3	Нагоре -- надолу: 50 мм	Да	Нагоре -- надолу: 50 мм	Rodenstock Autorefractor Keratometer Стр. 2
7,4	Движение на опората за брадичка: 70 мм	Да	Движение на опората за брадичка: 70 мм	Rodenstock Autorefractor Keratometer Стр. 2
8	Сериен интерфейс RS 232	Да	Сериен интерфейс RS 232	Rodenstock Autorefractor Keratometer Стр. 2


*[Handwritten signature]*




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

									Стр. 2
9	Бграден термопринтер		Да						Rodenstock Autorefractor- Keratometer Стр. 2
10	Цветен дисплей: поне 5.5 инча TFT		Да				Бграден термопринтер		Rodenstock Autorefractor- Keratometer Стр. 2
	Цветен дисплей: поне 5.7 инча TFT								

Подпис, печат:   
 Дата: 1 март 2014  
 Име и фамилия: Владимир Петров  
 Длъжност: Директор  
 Наименование на участника: Клиника за офталмология



*Handwritten signatures*

*Handwritten signatures*

   
**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**За гаранционно обслужване**

Долуподписаният Петьо Ангелов Петков с лична карта <sup>21.23 41.1</sup> (21.23 41.1 / 5 33 10), издадена на <sup>21.23 41.1</sup> (21.23 41.1 / 5 33 10) от <sup>21.23 41.1</sup> (21.23 41.1 / 5 33 10), с ЕГН <sup>21.23 41.1</sup> (21.23 41.1 / 5 33 10) в качеството ми на управител на консорциум „Адиглас“ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “

**“ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА И ДРУГА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МУ-СОФИЯ ПО 30 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”**  
**ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № 00398-2014-0017**

**ДЕКЛАРИРАМ**

че консорциум „Адиглас“ ще осигури гаранционно обслужване на апаратурата, доставена от „Адиглас“, от оторизиран от производителя сервиз на участника при максимално време на реакция 24 часа и максимално време за отстраняване на повредата 120 часа.

10 Юли 2014 г.

Декларатор:.....  
Петьо Петков







Роденщток Инструменте, Ам Вейшелгартен 19а, 91058, Ерланген

АДИТУС  
ТОТЛЕБЕН 34,  
СОФИЯ 1606,  
БЪЛГАРИЯ

## Декларация

Ние, Роденщток Инструменте, бизнес звено на Томей ГмбХ, намиращи се на Ам Вейшелгартен 19а, 91058, Ерланген, Германия, декларираме, че следните изделия:

Слит лампа-Биомикроскоп: RSL 3000  
Периметър: Perimat Automated Периметър  
Автоматичен рефрактометър: CX 2000

Са произведени след 01.01.2013

Ерланген 17.07.2014 г.

Роденщток Инструменте

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Rodenstock Instrumente, Am Weichselgarten 19a, 91058 Erlangen

**ADITUS**  
34 TOTLEBEN,  
SOFIA 1606,  
BULGARIA

### Declaration

We, **Rodenstock Instrumente**, business unit of Torney GmbH, addressed at Am Weichselgarten 19a, 91058, Erlangen, Germany, declared that following units

Slit Lamp: RSL 3000  
Perimeter: Perimat Automated Perimeter  
Autorefractor-Keratometer: CX 2000

Are manufactured after 01/01/2013

Erlangen, 17.07.2014

**Rodenstock Intrumente**  
Business unit of Tomey GmbH

**I.A. Clisia Zaccolo Werner**  
- Customer Service -

**R** **RODENSTOCK**  
Rodenstock Instrumente  
Am Weichselgarten 19a  
91058 Erlangen, Germany  
Tel. +49 9131 7771-777 Fax: -20  
www.rodenstock-instrumente.com

**i.V. Christa Papesch**  
- Deputy General Manager -

Rodenstock Instrumente  
Am Weichselgarten 19a, 91058 Erlangen, Deutschland

Tel.: +49 9131 777 1 777, Fax: +49 9131 777 1 20

www.rodenstock-instrumente.com  
info@rodenstock-instrumente.com

UST-IdNr.: DE 611664272  
Registergericht Fürth: HRB 5999  
Steuer-Nummer: 216/140/30027  
DIN EN ISO 9001 (2000)

Geschäftsführer: Yoshinobu Tanaka

Bankverbindung: UniCredit Bank AG  
Konto-Nr.: 13095671, BLZ: 760 200 70

IBAN: DE74760200700013095671, SWIFT: HYVEDEMM460

Rodenstock Instrumente ist ein Geschäftsbereich der Torney GmbH  
Rodenstock Instruments is a business unit of Torney GmbH



8 Юли 2014 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОСТАВКАТА

С цел за участие в търга ние, Оптилия Инструментс АЕ, производител на капилляроскопи и дерматоскопи, проверихме оборудването и декларираме, че всички доставени стоки за успешна кандидатура в търг от наш оторизиран представител

АДИТУС

Тотлебен 34


1606 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Тел / факс: +359 2 952 28 59

Е-поща: [aditus@einet](mailto:aditus@einet)

Ще бъдат произведени по поръчка или доставен от наличната продукция,  
произведена след 01.01.2013.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

08 July 2014

SUPPLY DECLARATION

For the purpose of participation in the tender we, Optilia Instruments AB the manufacturer of capillaroscopy and dermatology inspection equipment, hereby declare that any goods supplied against a successful tender bid by our authorised representative

ADITUS  
TOTLEBEN 34  
1606 SOFIA,  
BULGARIA  
TEL / FAX: +359 2 952 28 59  
E-mail: aditus@cinet

, will be manufactured to order or supplied from stock manufactured after 01/01/2013.

  
Alistair Gooch  
Marketing and Sales Manager, Medical

**Adress:**  
Optilia Instruments AB  
Djupdalsvägen 22  
192 51 Sollentuna  
Sverige

**Telefon:**  
08-35 33 60  
**Fax:**  
08-35 33 63

**E-mail:**  
[Info@optilia.eu](mailto:Info@optilia.eu)  
**Internet:**  
[www.optilia.eu](http://www.optilia.eu)

**Organisationsnr.**  
556636-6943  
**Momsreg.nr.**  
SE556636694301

МИКРОМЕД СПА

Дата: 10 Юли 2014 г.

НАШ REF 003-12 Declaration.doc

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, Микромед СПА, сме производители на ЕМГ, ЕР, ИОМ, LTM Express, EEG, ние заявяваме, че уредите за търг с номер 00398-2014-0017 на Медицински Университет - София са произведени след 01 Януари 2013 г..

Подпис: Мениджър продажби

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



ELETTROMEDICALI

Date: July 10<sup>th</sup>, 2014

our ref 003-12 Declaration.doc

## Declaration

We, Micromed SpA , as producers of EMG, EP, IOM, LTM Express, EEG , we declare that the equipment for auction number 00398-2014-0017 of the Medical University of Sofia is manufactured after January 1, 2013.


Mr. Alessandro Pesce  
Export Sales Area Manager

Micromed S.p.A.  
Via Giotto 2, 31021 Mogliano Veneto, Treviso - Italy  
Tel: +39-041-593 7000 - Fax: +39-041-593 7011  
Business Registry of Treviso Registration Number TV03906850262  
VAT number IT03906850262



QUALITY SYSTEM CERTIFIED - UNI EN ISO9001 - UNI CEI EN. ISO13485

Декларация

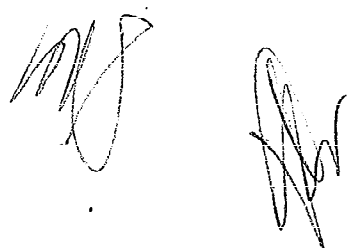

Тonica Elektronik A/S декларираме че произведената апаратура за търг на Медицински университет-София с номер 00398-2014-0017 е произведена след 01/01/2013.

За Тоника Електроник А/С


14 Юли 2014 г.

Пдшипс:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



50  
**Tonica Elektronik A/S**



**DECLARATION**

Tonica Elektronik A/S declare that produced equipment auction of the Medical University of Sofia number 00398-2014-0017 produced after 01/01/2013.

For Tonica Elektronik A/S

Jan Kjøller  
QA/RA Manager

July/14/2014



**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**За доставка на Ръководство за експлоатация на български език**

Долуподписаният Петьо Ангелов Петков с лична карта № <sup>21.23.01.1</sup> 107 3310, издадена на <sup>21.23.01.1</sup> г. от <sup>21.23.01.1</sup> от 3310, с ЕГН <sup>21.23.01.1</sup> 5 3310, в качеството ми на управител на консорциум „Адиглас” – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “

**“ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА И ДРУГА АПАРАТУРА ЗА НУЖДТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МУ-СОФИЯ ПО 30 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”**  
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № 00398-2014-0017

**ДЕКЛАРИРАМ**

че предлаганата от консорциум „Адиглас” апаратура ще бъде окомплектована с Ръководство за експлоатация на апаратурата на български език, ако консорциум „Адиглас” бъде определен за изпълнител.

10 Юли 2014 г.

Декларатор:  
Петьо Петков



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Декларация

Ние, Роденцок Инструменте, бизнес звено на Томей ГмбХ, намиращо се на Ам  
Вейшелгартен 19а, 91058, Ерланген, Германия, обявяваме, че

произведеното оборудване, за търг на Медицински университет София с номер  
00398-2014-0017 отговаря на техническите параметри, посочени в техническата  
спецификация.

Ерланген 15.07.2014 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pavel' or similar, written vertically.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pavel' or similar, written vertically.





Rodenstock Instrumente, Am Weichselgarten 19a, 91058 Erlangen

### Declaration

We, **Rodenstock Instrumente**, business unit of Torney GmbH, addressed at Am Weichselgarten 19a, 91058, Erlangen, Germany, declared that

produced equipment auction of the Medical University of Sofia number 00398-2014-0017 meets the technical parameters specified in the technical specification.


Erlangen, 15.07.2014

**Rodenstock Instrumente**

i.A. Clisia Zaccolo Werner  
- Customer Service -

**R** **RODENSTOCK**  
Rodenstock Instrumente  
Am Weichselgarten 19a  
91058 Erlangen, Germany  
Tel. +49 9131 7771-777 Fax: -20  
www.rodenstock-instrumente.com

i.V. Christa Papesch  
- Deputy General Manager -



Rodenstock Instrumente  
Am Weichselgarten 19a, 91058 Erlangen, Deutschland

Tel.: +49 9131 777 1 777, Fax: +49 9131 777 1 20

www.rodenstock-instrumente.com  
info@rodenstock-instrumente.com

UST-IdNr.: DE 811884272  
Registergericht Fürth: HRB 5999  
Steuer-Nummer: 216/140/30027  
DIN EN ISO 9001 (2000)

Geschäftsführer: Yoshinobu Tanaka

Bankverbindung: UniCredit Bank AG  
Konto Nr.: 13095671, BLZ: 760 200 70

IBAN: DE74760200700013095671, SWIFT: HYVEDEMM460

Rodenstock Instrumente ist ein Geschäftsbereich der Torney GmbH  
Rodenstock Instruments is a business unit of Torney GmbH

08 Юли 2014

## Декларация

Ние от Оптииа Инструменте АБ декларираме, че апаратите за търг 00398-2014-0017 на Медицински университет София отговарят на техническите параметри, посочени в техническата спецификация.

Менджър маркетинг и продажби

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА





08 July 2014

### DECLARATION

We at Optilia Instruments AB declare that apparatus for auction 00398-2014-0017 Medical University of Sofia meet the technical parameters specified in the technical specification.

**SVERIGE**  
**Optilia**

Alistair Gooch  
Marketing & Sales Manager, Medical


Дата: 10 Юли 2014  
наш REF 003-09 Declaration.doc

Декларация

Ние, Микромед СПА, производители на EMG, EP, IOM, LTM Express, EEG, ние декларирам, че устройството, което ще бъде доставено до Медицинския университет в София аукцион номер 00398-2014-0017, отговаря на техническите параметри, посочени в техническата спецификация.

Г-н Алесандро Песке  
Мениджър продажби

ВАРНО С ОРБИ





ELETTROMEDICALI

Date: July 10<sup>th</sup>, 2014


our ref 003-09 Declaration.doc

## Declaration

We, Micromed SpA , as producers of EMG, EP, IOM, LTM Express, EEG , we declare that the device, which will be delivered to the Medical University of Sofia auction number 00398-2014-0017 meets the technical parameters specified in the technical specification.

Mr. Alessandro Pesce  
Export Sales Area Manager

Micromed S.p.A.  
Via Giotto 2, 31021 Mogliano Veneto, Treviso - Italy  
Tel: +39-041-593 7000 - Fax: +39-041-593 7011  
Business Registry of Treviso Registration Number TV03906850262  
VAT number IT03906850262



QUALITY SYSTEM CERTIFIED - UNI EN ISO9001 - UNI CEI EN. ISO13485

ДЕКЛАРАЦИЯ


Тоника Електроник А/С декларираме че произведената апаратура за търг на Медицински университет-София с номер 00398-2014-0017, отговаря на техническите параметри посочени в техническата спецификация.

За Тоника Електроник А/С

14 Юли 2014 г.

Подпис:


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# Tonica Elektronik A/S





## DECLARATION

Tonica Elektronik A/S declare that produced equipment auction of the Medical University of Sofia number 00398-2014-0017 meets the technical parameters specified in the technical specification.

For Tonica Electronic A/S

  
-----  
Jan Kjølner  
QA/RA Manager

July/14/2014



Сертификат

До Медицински Университет София

Ние, НИДЕК КО, ЛГД, с адрес 34014 Маехама. Хироиши-чо, Гамагори, Аичи, 443-0038, Япония, тук потвърждаваме, че Униглас ООД, с адрес Варна 9000, ул. Драгоман 36, е оторизиран дистрибутор в България и Униглас може да участва за доставка на Оптичен кохерентен томограф (RS-3000 Advance, RS-3000 Lite), изработен след 1<sup>ри</sup> Януари 2014. Ние също потвърждаваме, че RS-3000 Advance и/или RS-3000 Lite ще бъдат доставени на Униглас при Стандартни условия. Ние също потвърждаваме, че техническата спецификация на RS-3000 Advance и/или RS-3000 Lite, кореспондира на спецификацията, описана в търга.

Валидност: 31 Декември 2014

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА







# NIDEK CO., LTD. INTERNATIONAL DIVISION.

3F Sumitomo Fudosan Hongo Bldg., 3-22-5, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033, Japan  
Manufacturers, Exporters & Importers of Ophthalmic Instruments, and Opto-Electronics Instruments

TEL +81-3-5844-2641  
FAX +81-3-5844-2642  
URL <http://www.nidek.co.jp>  
<http://www.nidek.com>

## CERTIFICATE

To Medical University Sofia

We, NIDEK CO., LTD., located at 34-14 Maehama, Hiroishi-cho, Gamagori, Aichi, 443-0038, Japan, here confirm as of the date hereof that Uniglass Ltd, located at Varna 9000 36 Dragoman Str., is an authorized distributor in Bulgaria, and Uniglass Ltd can submit a bid for the purpose of providing Optical Coherence Tomography (RS-3000 Advance, RS-3000 Lite) manufactured after 1<sup>st</sup> January 2014. We also confirm that RS-3000 Advance and/or RS-3000 Lite will be supplied to Uniglass Ltd. under Standard terms. We also confirm that the technical specifications of RS-3000 Advance and/or RS-3000 Lite correspond to the specifications described on the tender.

Validity: 31 December 2014

Yours sincerely,

Katsumi Kondo  
Corporate officer and senior manager  
of International Sales Dept.  
NIDEK CO., LTD



# NIDEK CO., LTD. INTERNATIONAL DIVISION.

3F Sunioma Fudosen Hongo Bldg., 3-22-5, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033, Japan  
Manufacturers, Exporters & Importers of Ophthalmic Instruments, and Opto-Electronics Instruments

TEL +81-3-5844-2641  
FAX +81-3-5844-2642  
URL <http://www.nidek.co.jp>  
<http://www.nidek.com>

## C E R T I F I C A T E

To Medical University Sofia

We, NIDEK CO., LTD., located at 34-14 Maehama, Hiroishi-cho, Gamagori, Aichi, 443-0038, Japan, here confirm as of the date hereof that Uniglass Ltd, located at Varna 9000 36 Dragoman Str., is an authorized distributor in Bulgaria, and Uniglass Ltd can submit a bid for the purpose of providing Optical Coherence Tomography (RS-3000 Advance, RS-3000 Lite) manufactured after 1<sup>st</sup> January 2014. We also confirm that RS-3000 Advance and/or RS-3000 Lite will be supplied to Uniglass Ltd. under Standard terms. We also confirm that the technical specifications of RS-3000 Advance and/or RS-3000 Lite correspond to the specifications described on the tender.

Validity: 31 December 2014

Yours sincerely,

Katsumi Kondo  
Corporate officer and senior manager  
of International Sales Dept.  
NIDEK CO., LTD

ДО  
РЕКТОРА НА  
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

## Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена/и позиция/ии № 6

«Апаратура за Катедра по «Неврология

*/изписват се номерата и наименованията на обособените позиции, за които се участва/*

от Консорциум „Адиглас“ представлявано от Петьо Петков

*/наименование на участника/*


БУЛСТАТ/ЕИК 176 720 927 адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Тодор Левски“ 34, лице за контакт Петьо Петков, тел. за връзка +359/29522859 факс +359/29522859

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при МУ-София по 30 обособени позиции“ с настоящата представяме нашето ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 «Апаратура за Катедра по «Неврология»

Обособена позиция №	Наименование на артикула	мярка	Кол.	Един. Цена в лв. (без ДДС)	Обща стойност в лв. (без ДДС)	Обща стойност в лв. (с ДДС)	Ограничен финансов ресурс в лв. (без ДДС)
6.1	Компютърен периметър.	Бр.	1	41 660,00	41 660,00	49 992,00	41 666,67



6.2	Оптично-кохерентен томограф.	Бр.	2	133 330,00	266 660,00	319 992,00	266 666,66
6.3	Шпалт-лампа (биомикроскоп).	Бр.	2	16 665,00	33 330,00	39 996,00	33 333,34
6.4	Видеокаплярскоп от най-висок клас.	Бр.	1	16 660,00	16 660,00	19 992,00	16 666,67
6.5	Апаратура и програми за съвременно видео-ЕЕГ мониториране и полисомнография.	Бр.	1	133 330,00	133 330,00	159 996,00	133 333,33
6.6	Апаратура за транскраниална магнитна стимулация.	Бр.	1	133 330,00	133 330,00	159 996,00	133 333,33
6.7	Автоматичен рефрактометър.	Бр.	1	33 330,00	33 330,00	39 996,00	33 333,33
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ:</b>					658 300,00	789 960,00	658 333,33

Предлаганата цена е с включени всички съпътстващи разходи по доставката до крайния получател, монтажа, пускането в експлоатация, обучението на персонала за работа с апаратурата и гаранционната поддръжка, включително митни сборове, такси и други данъци при внос или други вземания и данъци, включително ДДС.


Съгласни сме:

- при установяване на допуснати несъответствия и неточности на стойността в лв. без ДДС и /или с ДДС, Комисията да отстрани аритметични грешки при спазване на правилото, че за верен се приема записът посочен в колона „Единична цена в лв. без ДДС“ ;  
 - при непосочване на цена за всякой от артикулите, предложението да бъде отстранено от участие и да не бъде класирано;  
 - при подаване на ценово предложение за артикул, който надвишава определения от Възложителя ограничен финансов ресурс да бъде отстранен от участие в процедурата.

- при представяне на цена в лева /без ДДС и с ДДС/ за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция или подпозиция по-висока от определения от Възложителя ограничен финансов ресурс да бъдем отстранени от участие в процедурата.

Запознат съм с определения от Възложителя ограничен финансов ресурс за изпълнение на поръчката за обособената позиция, за която участваме.

Съгласни сме валидността на нашата ценова оферта да бъде 180 календарни дни, но не по-малко от 180 календарни дни, считано от датата определена за краен срок за получаване на офертите. До подписването и подписването на официалния договор, тази оферта, заедно



с писменото потвърждение от Ваша страна и известие за възлагане на поръчката ще формираат обвързващо споразумение между двете страни.

Уведомени сме, че предлаганата цена е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.



Подпис и печат: .....

Дата: 10 / Юли / 2014 г.

Име, фамилия: Петьо Петков

Длъжност: Управител

Наименование на участника: Консорциум «Адиглас»

Упълномощен да подпише предложението /в случай, че това не е законния представител на участника./

.....  
(изписва се името на Участника)

.....  
(изписва се името на упълномощеното лице с длъжността, като в този случай се прилага пълномощно – оригинал или с нотариална заверка)

*Подпис и печат от участника на всяка страница!*

